



# 防爆ブース 参考図

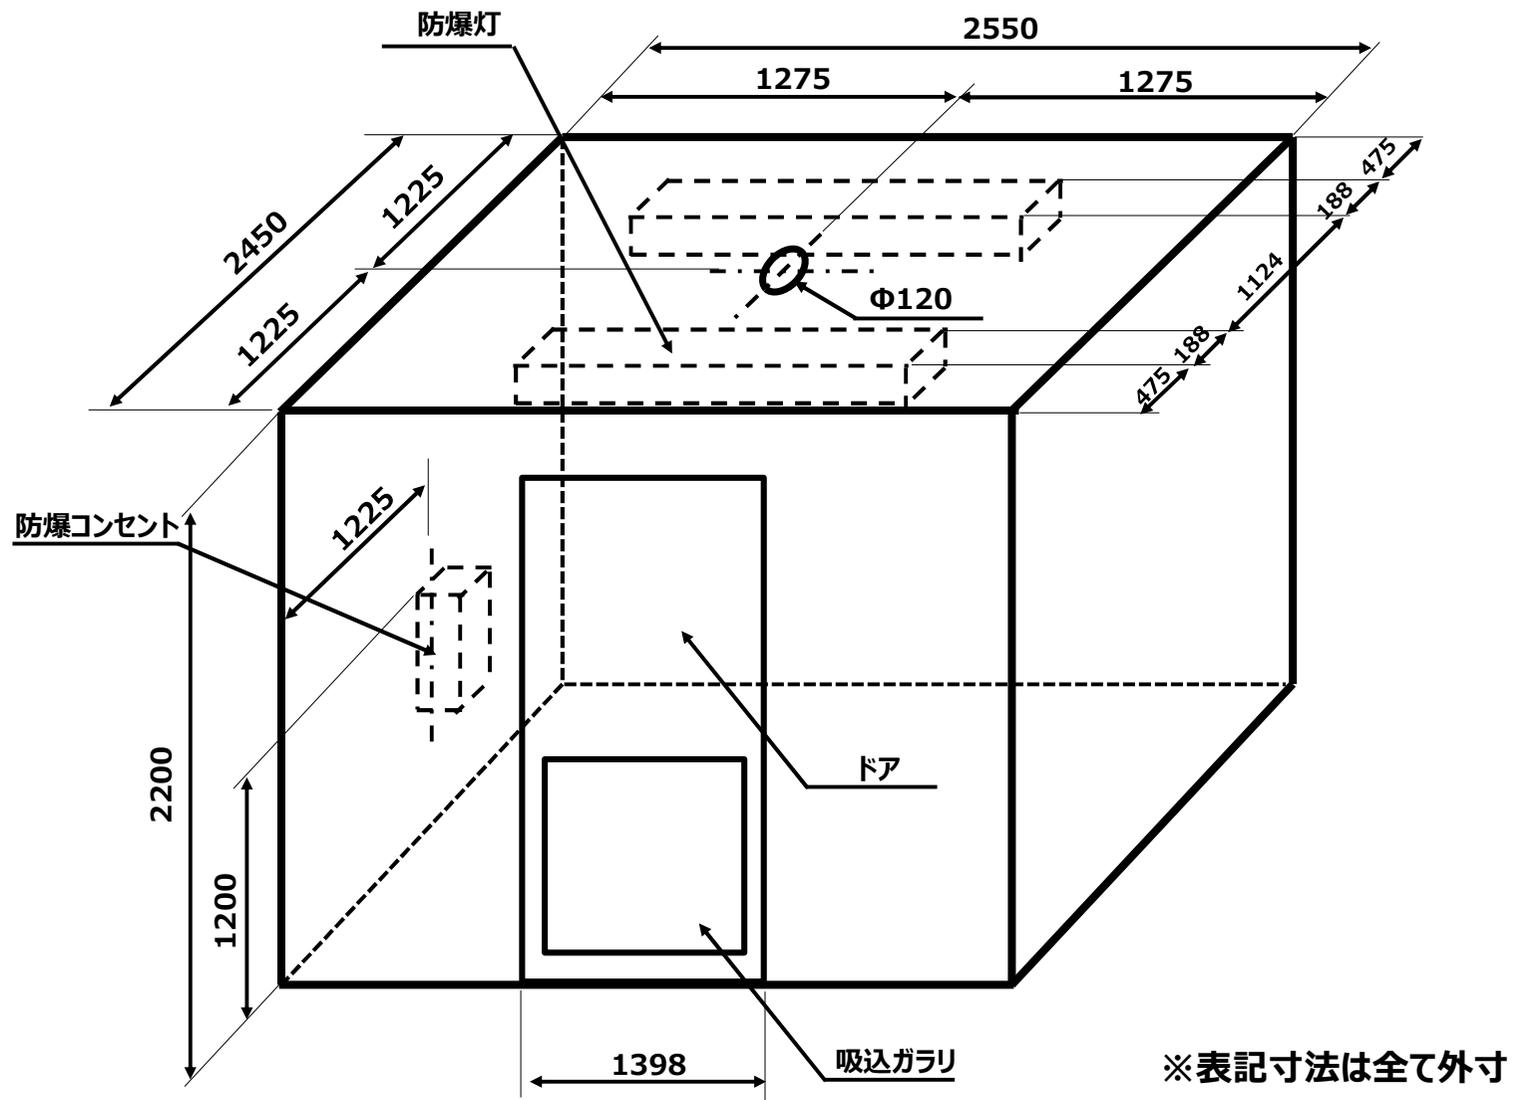

# ■ ガス配管の取り合いについて

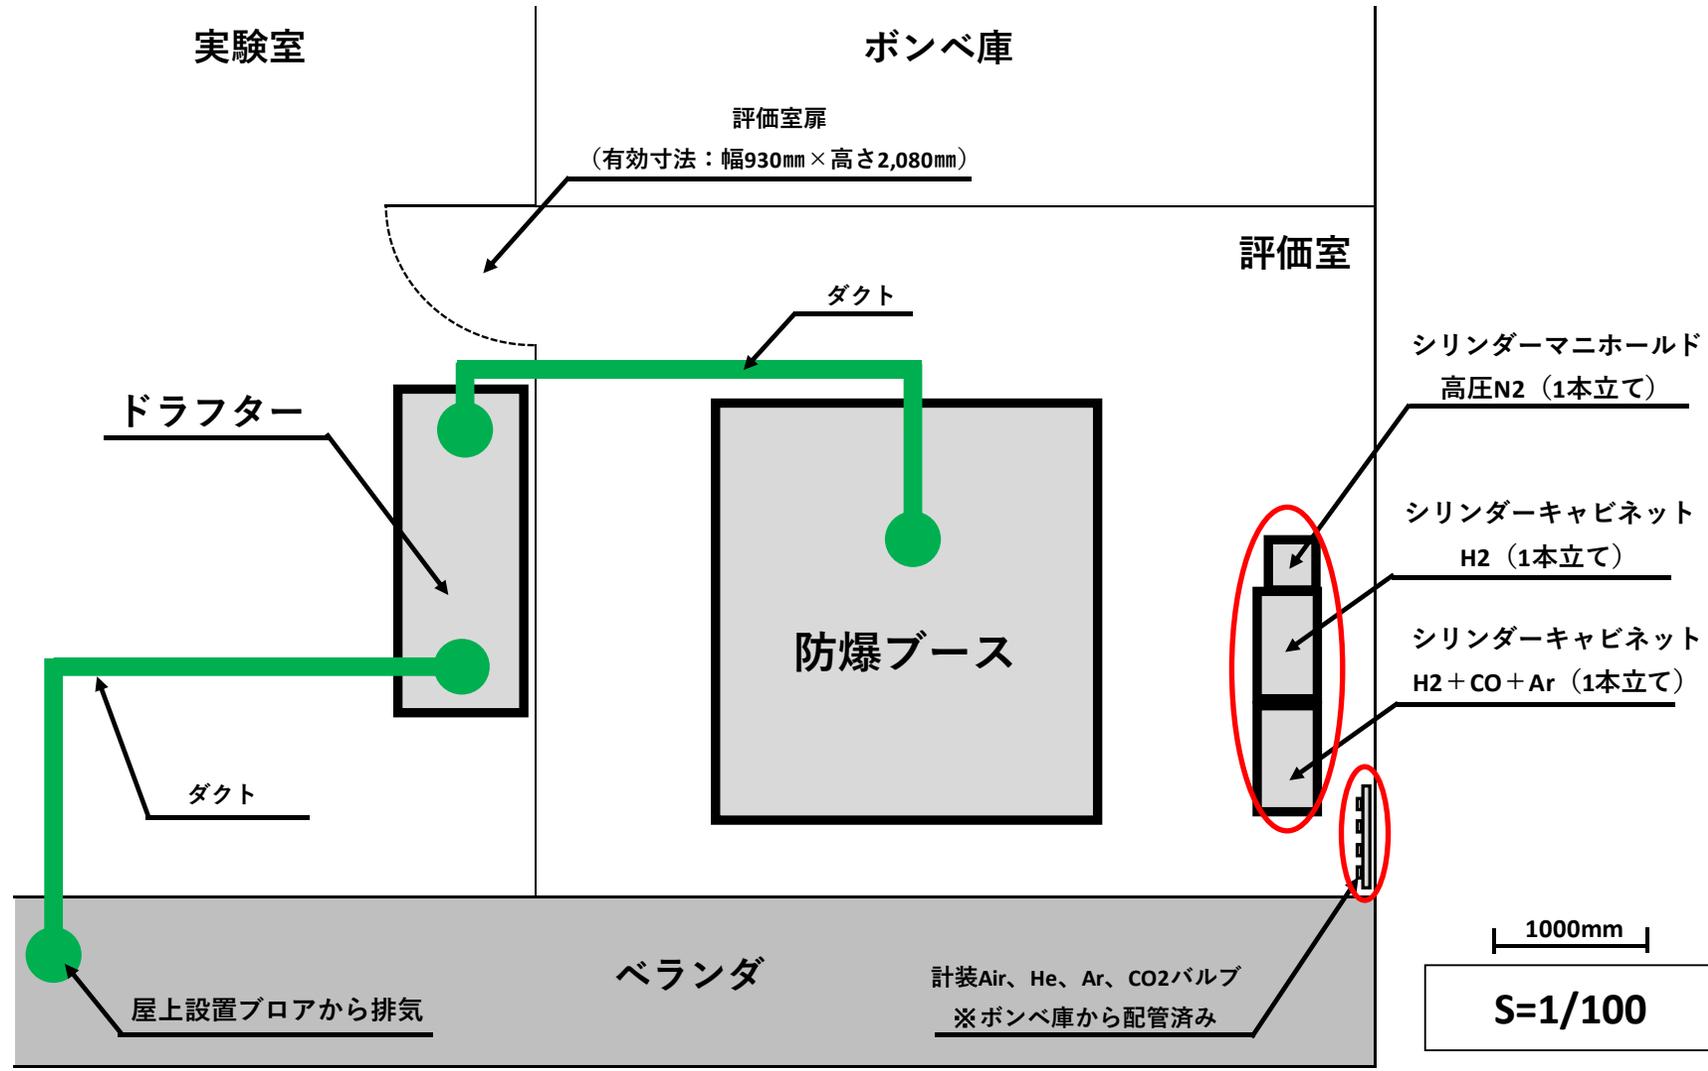

- ・ 可燃性ガス、高圧ガスの取り合いは、シリンダーキャビネット及びシリンダーマニホールドの減圧弁下流とする。
- ・ ガスクロに使用するガス及び計装Airは、ボンベ庫よりガス配管を評価室内に敷設し、同室内に減圧弁を設置。減圧弁下流にて取り合い。
- ・ 取り合い部分の配管サイズは1/4"。可燃性ガスはSUS溶接配管を用い、継手を用いる場合はメタルガスケット継手とする。